



בית החולים האוניברסיטאי של הדסה
טל. 02-6777356 פקס. 02-6778918

92261

שם חיים חן אוזן	ת.ז. 27152297	גיל 51 שנים	תאריך 28/01/2026
אודיומטר	נבדק ע"י ארווה קניבי	מס. רשיון 142822	136623/319359
המפנה	ד"ר ויזל יוחנן	קופ"ח	
סיבת הפניה	הערכת עיבוד שמיעה		

טסטים מרכזיים

	Right	Left	
SPN Threshold(dB)	10	10	SPN סף
SRT Threshold(dB)	10	10	SRT סף
Silent Disc(%)	96	92	דיסקרימינציה בשקט
S/N Ratio 40/40	64	56	S/N Ratio 40/40
% Compressed Speech	80		קשב מפוצל
Competing Sentences Short(%)			דיכוטי S/C קצר
Competing Sentences Long(%)			דיכוטי S/C ארוך
Threshold of Interference(dB)			Threshold of Interference(dB)

אנמנזה:

28/01/2026

הערות: בן 51, מגיע להערכת עיבוד שמיעה עקב תלונות על קשיי שמיעה שהולך ומחמיר בשנים האחרונות. לדבריו עבר ת"ד ב 2018 ומאז הוא מרגיש את הקושי בשמיעה. נבדק מדווח שהקושי גובר על רקע רעש. בנוסף, מציין רגישות יתר לרעשים חזקים. שולל אטימות או סחרחורת אם כי מלין על טנטון לסירוגין שקשור יותר להתקפים של כאבי ראש. בדיקת שמיעה מ 08/2025 מציגה ירידה מזערית-קלה עם שקע ב 4000 הרץ מסוג S/N דו"צ. אוזניים במ"פ לפי בדיקת רופא א"ג מ 08/2025

תוצאות:

ימין:

שמאל:

תוצאות ההערכה-

בדיקת Binaural masking level difference - אנטראקציה דו צדדית - תוצאות בתחום הנורמה. תת מבחן דיסקרימינציה- אבחנה שמיעתית/ חזרה על מילים חד הברתיות בשקט: מימין ומשמאל תוצאות תקינות. תת מבחן דיסקרימינציה- אבחנה שמיעתית/ חזרה על מילים חד הברתיות על רקע רעש: בשתי האוזניים תוצאות בתחום הנורמה מימין 64%. משמאל תוצאות ממתחת לתחום הנורמה 56%. תת מבחן קשב מפוצל- חזרה על שני מסרים שונים, הניתנים לכל אוזן, בו זמנית: מימין ומשמאל תוצאות תקינות. בדיקת Gap Detection - זהוי מרווח של 5-15 מילישניות בין צלילים עוקבים- תוצאות תקינות. בדיקת Pitch Pattern Sequence - תוצאות בתחום הנורמה.

סיכום ההערכה-

על פי תוצאות הבדיקות היום ישנם מבחנים בבטריט עיבוד שמיעה אשר התקבלו בהם תוצאות מתחת לתחום הנורמה אם כי לא ניתן לתת אבחנה של הפרעות בעיבוד שמיעה עקב חוסר תגובות בבדיקת DPOAE בתדירויות גבוהות וספי שמיעה שאינם בתחום הנורמה לפי בדיקה התנהגותית.

הערות:

-בבדיקת EHF ספי השמיעה התקבלו כמצופה מהגיל בתדרים 9000-16000 הרץ בטווח אחוזון 95 לפי Rodriguez Valiente et al. 2014
- בבדיקת רפלקסים אקוסטיים נרשמו רפלקסים לגירוי איפסי ימין ושמאל בתדרים 500 ו 1000 בלבד בעוצמות מעט מעל הנורמה.
לא נרשמו רפלקסים לגירוי קונטרא ימין ושמאל לא כצופה מספי השמיעה; נרשם רפלקס אחד לגירוי קונטרא שמאל בתדר 2000 הרץ בעוצמה מעל הנורמה.
יש לציין שנבדק עבר בבדיקת ABR BTT ב 08/2025 לפיה לא נמצא הבדל בין האוזניים, מורפולוגיה, חביון ואמפליטודה של הגלים היו תקינים.
- בבדיקת פלט קוקלארי DPOAE נרשמו מימין תגובות בודדות בתדרים 1000 עד 3000 הרץ כולל. משמאל; נרשמו תגובות בודדות בתדרים 500 עד 3000 הרץ כולל.

המלצות:

חזרה עם התוצאות לרופא המפנה.
מומלץ שימוש במכשירי שמיעה LOW GAIN.
מומלץ מעקב שמיעה תקופתי אחד לשנה.

ארווה קניבי
קלינאית תקשורת MA
מ.ד. 13-142822



שם חיים חן און
ת.ז. 27152297
גיל 51 שנים
אודיומטר
נבדק ע"י ארווה קניבי
מס. רשיון 142822
קופ"ח
המפנה ד"ר יזל יוחנן
סיבת הפניה הערכת עיבוד שמיעה



92261

בית החולים האוניברסיטאי של הדסה
טל. 02-6777356 פקס. 02-6778918

Right											Left										
	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000		250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Air Mask Lvl																					
Bone Mask Lvl																					

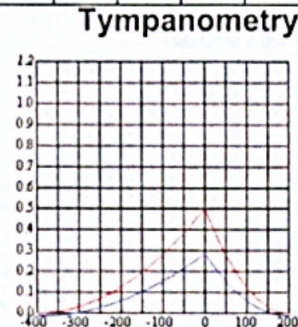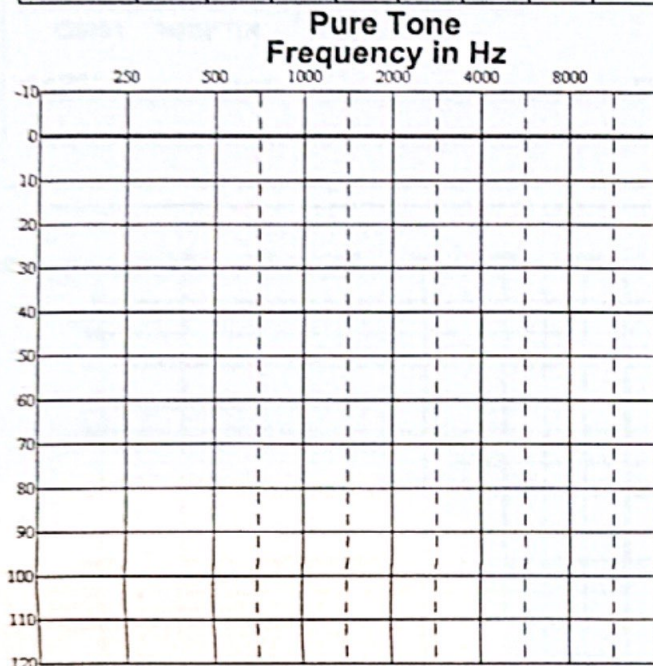

	Right	Left
Type	A 0	A 0
Compliance	0.5	0.3
Volume	1.5	1.2
ETF		

	Air	Air Mask	Bone	Bone Mask	MCL	UCL	Sound Field	Stenger	Hearing Aid	No Response	Weber
Right	○	△	<	□	MCL	UCL	S	ST	HA	NR	↑ ← →
Left	×	□	>	□	MCL	UCL	S	ST	HA	NR	

שפה:

	Probe In	/500Hz Decay	/1000Hz Decay	2000Hz	4000Hz	
Sound in Right	Right	85	90	NR		Ipsi
	Left	NR	NR	NR		Contra
Sound in Left	Right	NR	NR	100		Contra
	Left	95	95	NR		Ipsi

28/01/2026

אנמנזה:

הערות: בן 51, מגיע להערכת עיבוד שמיעה עקב תלונות על קשיי שמיעה שהולך ומחמיר בשנים האחרונות. לדבריו עבר ת"ד ב 2018 ומאז הוא מרגיש את הקושי בשמיעה. נבדק מדווח שהקושי גובר על רקע רעש. בנוסף, מציין רגישות יתר לרעשים חזקים. שולל אטימות או סחרחורת אם כי מלין על טנטון לסירוגין שקשור יותר להתקפים של כאבי ראש. בדיקת שמיעה מ 08/2025 מציגה ירידה מזערית-קלה עם שקע ב 4000 הרץ מסוג S/N דו"צ. אוזניים במ"פ לפי בדיקת רופא א"ג מ 08/2025

שתי האוזניים:

תוצאות:

בבדיקת EHF ספי השמיעה התקבלו כמצופה מהגיל בתדרים 9000-16000 הרץ בטווח אחוזון 95 לפי Rodriguez Valiente et al, 2014

הערות:

- בבדיקת רפלקסים אקוסטיים נרשמו רפלקסים לגירוי איפסי ימין ושמאל בתדרים 500 ו 1000 בלבד בעוצמות מעט מעל הנורמה.

ארווה קניבי
קלינאית תקשורת MA

מ.ה. 1141822

תוכנת קולגרף פותחה על ידי מרזו מערכות תוכנה בעמ טלפון 02 6527501

שם חיים חן אוזן
ת.ז. 27152297
גיל 51 שנים
אודיומטר
נבדק ע"י ארווה קניבי
המפנה ד"ר ויזל יוחנן
סיבת הפניה הערכת עיבוד שמיעה

28/01/202 תאריך
136623/319359
142822 מס. רשיון
קופ"ח



בית החולים האוניברסיטאי של הדסה
טל. 02-6777356 פקס. 02-6778918


92261

136623/319359

בדיקת שמיעה כולל תדירויות העל

שם הנבדק: חיים חן אוזן
תאריך לידה: 10/04/1974
תאריך הבדיקה: 28/01/2026
גורם מפנה:

ת.ז. 27152297
אודיומטר GSI61
רשיון: 142822
שם הבדוק: ארווה קניבי

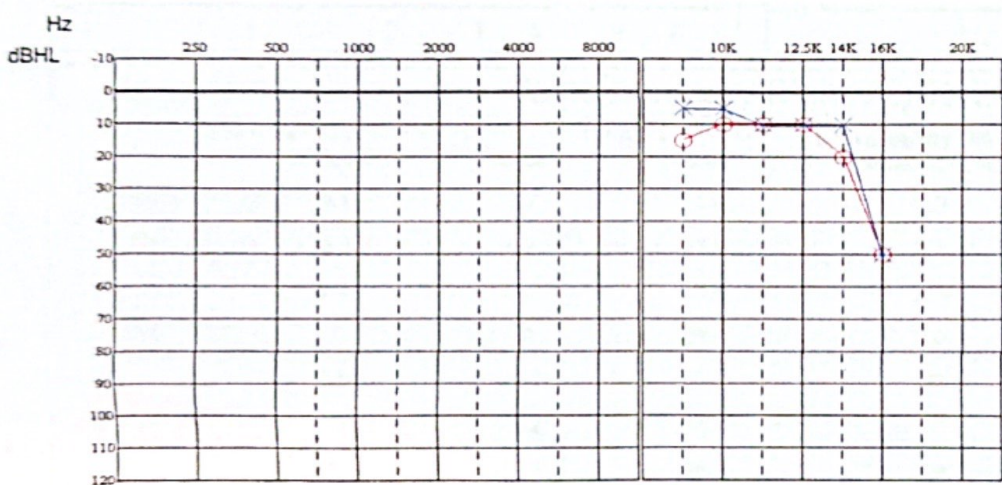

	Air	Air	Bone	Bone	MCL	UCL	Sound	Hearing	No	Weber
	Mask	Mask	Mask	Mask	MCL	UCL	Field	Stenger	Aid	Response
Right	○	△	<	□	MCL	UCL	S	ST	HA	NR
Left	×	□	>	□	MCL	UCL	S	ST	HA	NR

- בבדיקת EHF ספי השמיעה התקבלו כמצופה מהגיל בתדרים 9000-16000 הרץ בטווח אחוזון 95 לפי Rodriguez Valiente et al 2014
- בבדיקת רפלקסים אקוסטיים נרשמו רפלקסים לגירוי איפסי ימין ושמאל בתדרים 500 ו 1000 בלבד בעוצמות מעט מעל הנורמה.
לא נרשמו רפלקסים לגירוי קון המלצות:

חזרה עם התוצאות לרופא המפנה.
מומלץ שימוש במכשירי שמיעה LOW GAIN
מומלץ מעקב שמיעה תקופתי אחד לשנה.

Speech Audiometry

Speech	Rt	Mask	Lt	Mask	SF	HA Rt	HA Lt
SRT dB							
SRT Msk							
% Disc							
dB							
MCL							
UCL							
VDL							

אופן הגשה:
שפה:

ארווה קניבי
קלינאית תקשורת MA
מ.ר. 142822