

עמוד 1 מתוך 1

17/09/2026	ת. ביצוע:	31867933-9	ת"ז:	אהובה רננה מסלטון	נבדק:
17/09/2026	אישור פענוח:	27 שנים	גיל:	15/08/1999	תאריך לידה:
17/09/2026	ת. הדפסה:	נקבה	מין:	מחוז מרכז, (70000)	מוסד מפנה:
				מרפאת גני איילון, (74990)	גורם מפנה:
				אחמד שקיראת, (149688)	רופא מפנה:

בדיקה: צילום עמוד שדרה

—

סיבת הפניה:

קיימת הפניה ממוחשבת / סרוקה

בוצע:

צילום עמוד שדרה בתאריך 17/09/2026 12:32 מ.ג. 1015002249084 מבצע: סמדר אילן;
צילום עמוד שדרה צווארי במסגרת עמוד שדרה; צילום עמוד שדרה גבי במסגרת עמוד שדרה; צילום עמוד שדרה גבי/מותני
במסגרת עמוד שדרה; צילום עמוד שדרה מותני סקראלי במסגרת עמוד שדרה;

ממצאים:

צילום עמוד שדרה לכל האורך:
סקוליוזיס קלה קמורה שמאלה בקטע גבי תחתון.

צורה תקינה של כל החוליות .
מרווחים בין חולייתיים שמורים.

סיכום:

אושרר ע"י: ד"ר עירית הדס הלפרין מספר רשיון: 13889 17/9/2026 18:28

הודפס מאתר כללית ב-23.09.2026 בשעה 12:48 בעבור אהובה רננה מסלטון. תעודת זהות: 318679339.

Maslato, Ahuva Renana מַסְלָטוֹן אֲהוּבָה רֵנָנָה
27Y 1M,F,31867933
Laterality: U
SI:1 Patient ID : 31867933
Acc#: 1015002249084
Patient Name: MASLATON AHUVA RENANA
Study Desc: XR SPINE
Birth Date : 08/15/1999
Age : 27Y
Sex : Female

Dose Report

Exam Date : 09/17/2026
Time : 12:26
Accession # : 1015002249084
Procedure Description : WHOLEBODY

Clalit Ramat Eshkol
Page 1 of 1
9/17/2026 12:31:07 PM
DAP Sensor: 11375-02502J/L
Samsung Electronics
0.000kV, 0mAs
40% Pixel
DFOV 38.4 x 38.4 cm

No	Status	Protocol	kVp	mA	mAs	Receptor	SID (cm)	Patient Size	Collimator Size (cm)	AEC	Density	Filter (mm)	Grid (cm)	DAP (dGy*cm)	ESE	EI	DI	Operator	
1	Confirm	C-SPINE AP	67	200.0	6.2	Stand	110	MEDIUM	25.4X20.4	(0,1,0)	0	None	Display Nam...	0.731	228.59	252.61	-0.27	tech	
2	Confirm	C-SPINE LAT	70	200.0	4.8	Stand	110	MEDIUM	30.4X25.4	(0,1,0)	0	None	Display Nam...	0.914	191.79	297.16	0.56	tech	
3	Confirm	T-SPINE AP	75	200.0	10.4	Stand	110	MEDIUM	45.4X20.4	(0,1,0)	0	None	Display Nam...	2.632	460.41	254.98	1.03	tech	
4	Confirm	T-SPINE LAT	76	320.0	9.2	Stand	110	MEDIUM	45.4X24.2	(0,1,0)	0	None	Display Nam...	2.673	394.16	191.47	-0.10	tech	
5	Confirm	L-SPINE AP	80	400.0	18.4	Stand	110	MEDIUM	45.4X24.2	(0,1,0)	0	0.1mm Cu	Display Nam...	3.529	520.38	292.42	0.97	tech	
6	Confirm	L-SPINE LAT	94	400.0	15.2	Stand	110	MEDIUM	45.4X24.2	(0,1,0)	2	0.1mm Cu	Display Nam...	4.300	634.07	175.83	-1.48	tech	

10 cm

Maslato, Ahuva Renana אהובה רננה
27Y 1M,F,31867933
SI:1
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: CSPINE
< 2-1 >

Clalit Ramat Eshkol
שקידאת, אחוד
9/17/2026 12:28:09 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
67.000kV, 6mAs
tech
56% Pixel
DFOV 25.4x25.4 cm



Maslaton, Ahuva Renana אהובה רמון
27Y 1M,F,31867933
SI:2
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: CSPINE
< 2 - 2 >

Clalit Ramat Eshkol
שקידא, אחוד
9/17/2026 12:30:52 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
70.000kV, 5mAs
tech
56% Pixel
DFOV 25.4x25.4 cm



Maslaton, Ahuva Renana , אחובה רננה מסלון
27Y 1M,F,31867933
SI:1
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: TSPINE
< 3 - 1 >



Clalit Ramat Eshkol
שקיראת, אחוד
9/17/2026 12:28:27 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
75.000kV, 10mAs
tech
34% Pixel
DFOV 42.5 x 42.5 cm



10 cm

Maslato, Ahuva Renana
27Y 1M,F,31867933
SI:2
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: TSPINE
< 3 - 2 >


STANDING

Clalit Ramat Eshkol
שקיראת, אחוז
9/17/2026 12:30:18 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
76.000kV, 9mAs
tech
34% Pixel
DFOV 42.5 x 42.5 cm



10 cm

Maslato, Ahuva Renana
27Y 1M,F,31867933
SI:1
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: LSPINE
< 4-1 >

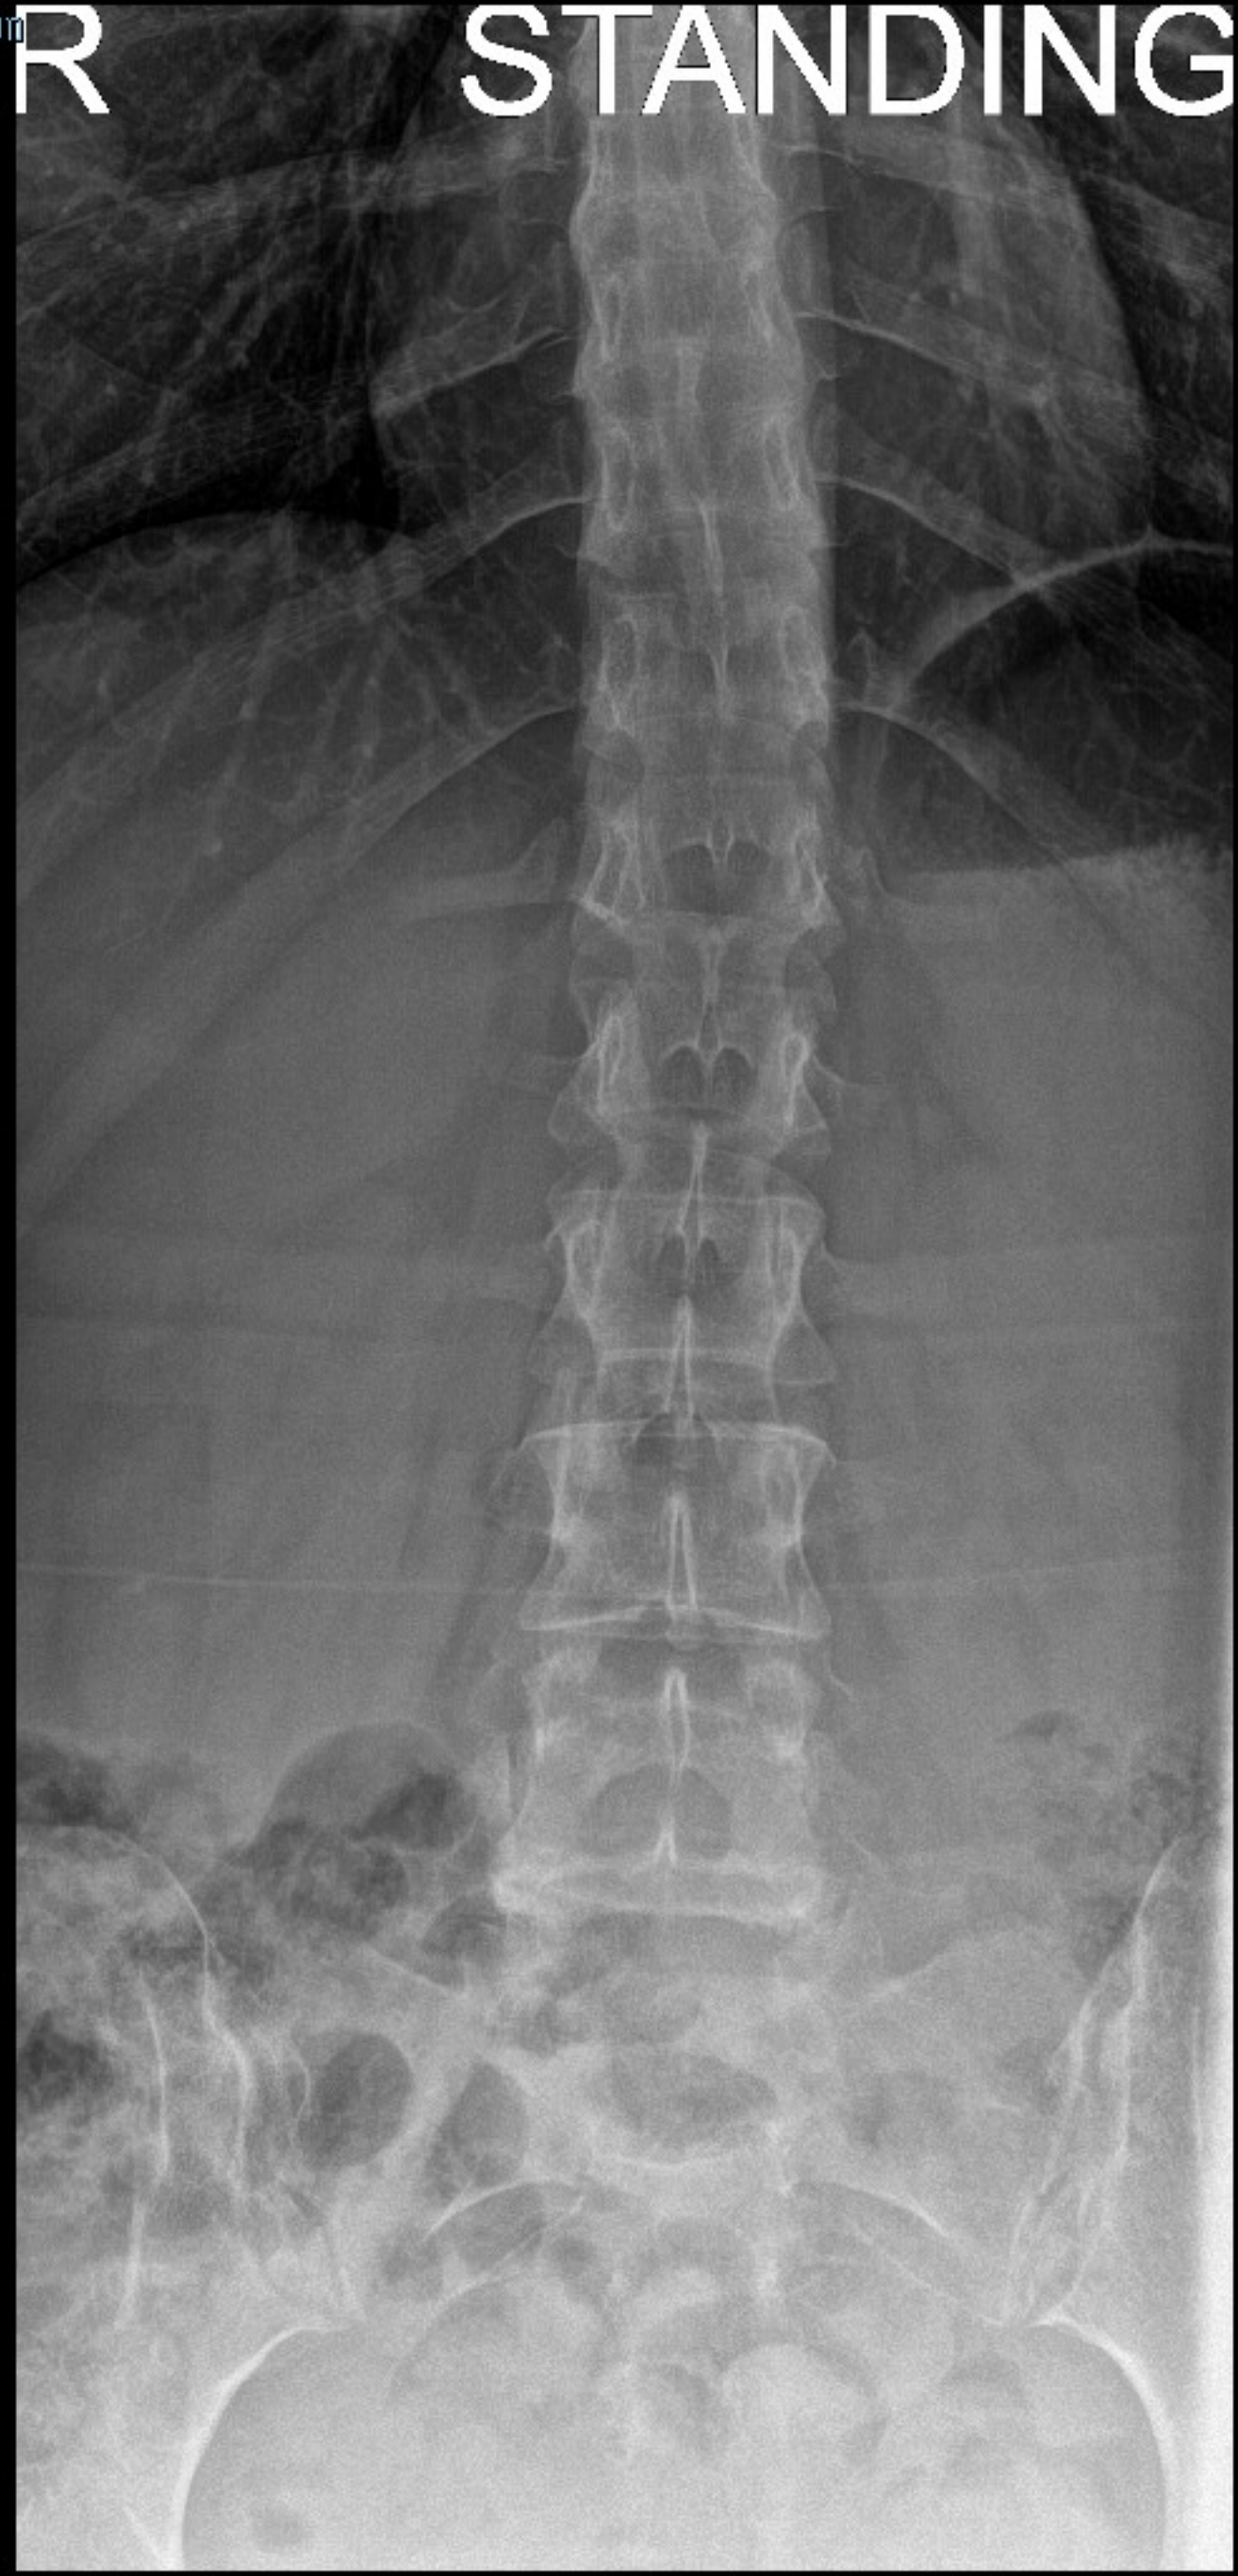

Clalit Ramat Eshkol
שקיראת, אחוז
9/17/2026 12:28:45 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
80.000kV, 18mAs
tech
34% Pixel
DFOV 42.5 x 42.5 cm



10 cm

Rel X Ray Exp: 520

C 8192
W 16383

Maslato, Ahuva Renana
27Y 1M,F,31867933
SI:2
Acc#: 1015002249084
Study Desc: XR SPINE
Series Desc: LSPINE
< 4 - 2 >

STANDING

Clalit Ramat Eshkol
שקיראת, אחמד
9/17/2026 12:29:14 PM
Samsung Electronics DGR-C25U2J/IL
94.000kV, 15mAs
tech
34% Pixel
DFOV 42.5 x 42.5 cm



10 cm